


THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения

Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

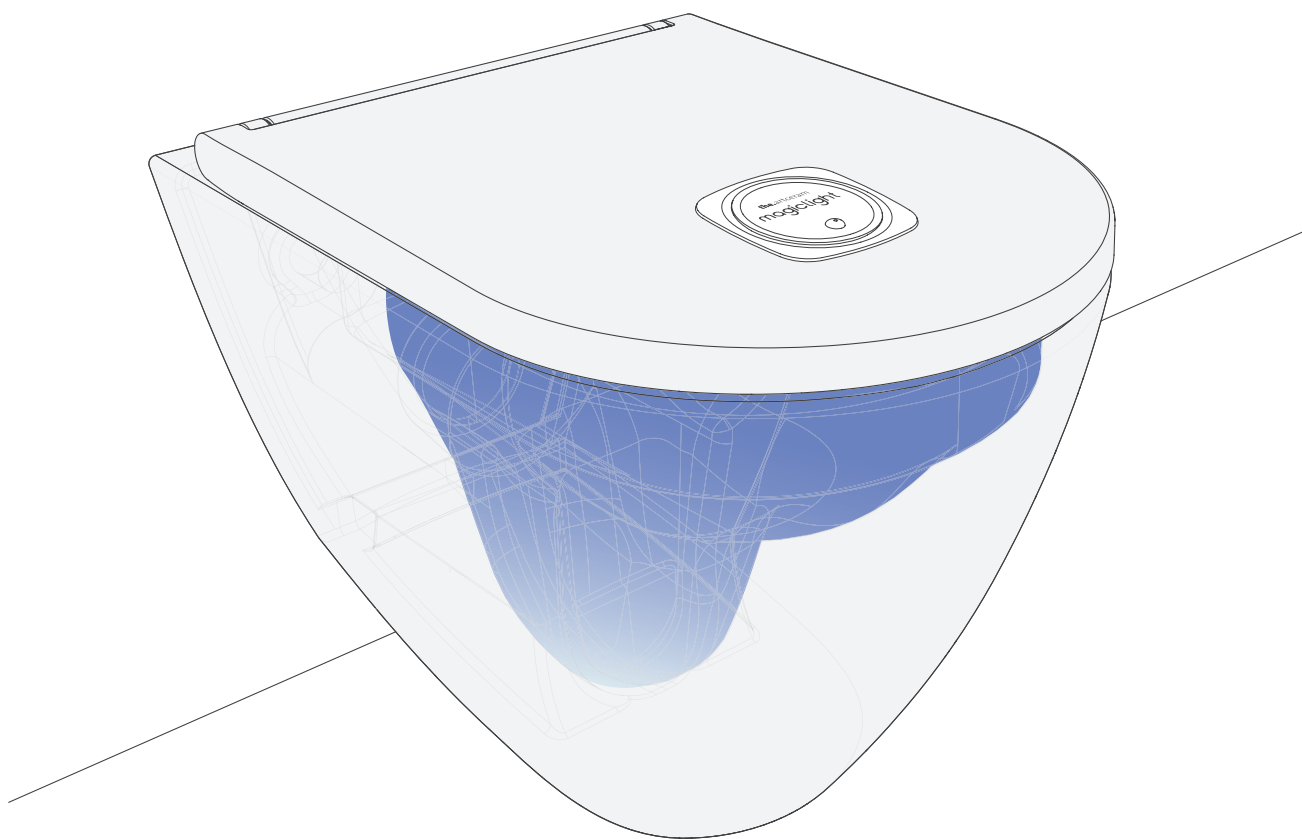

THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения


Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device



THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения

Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

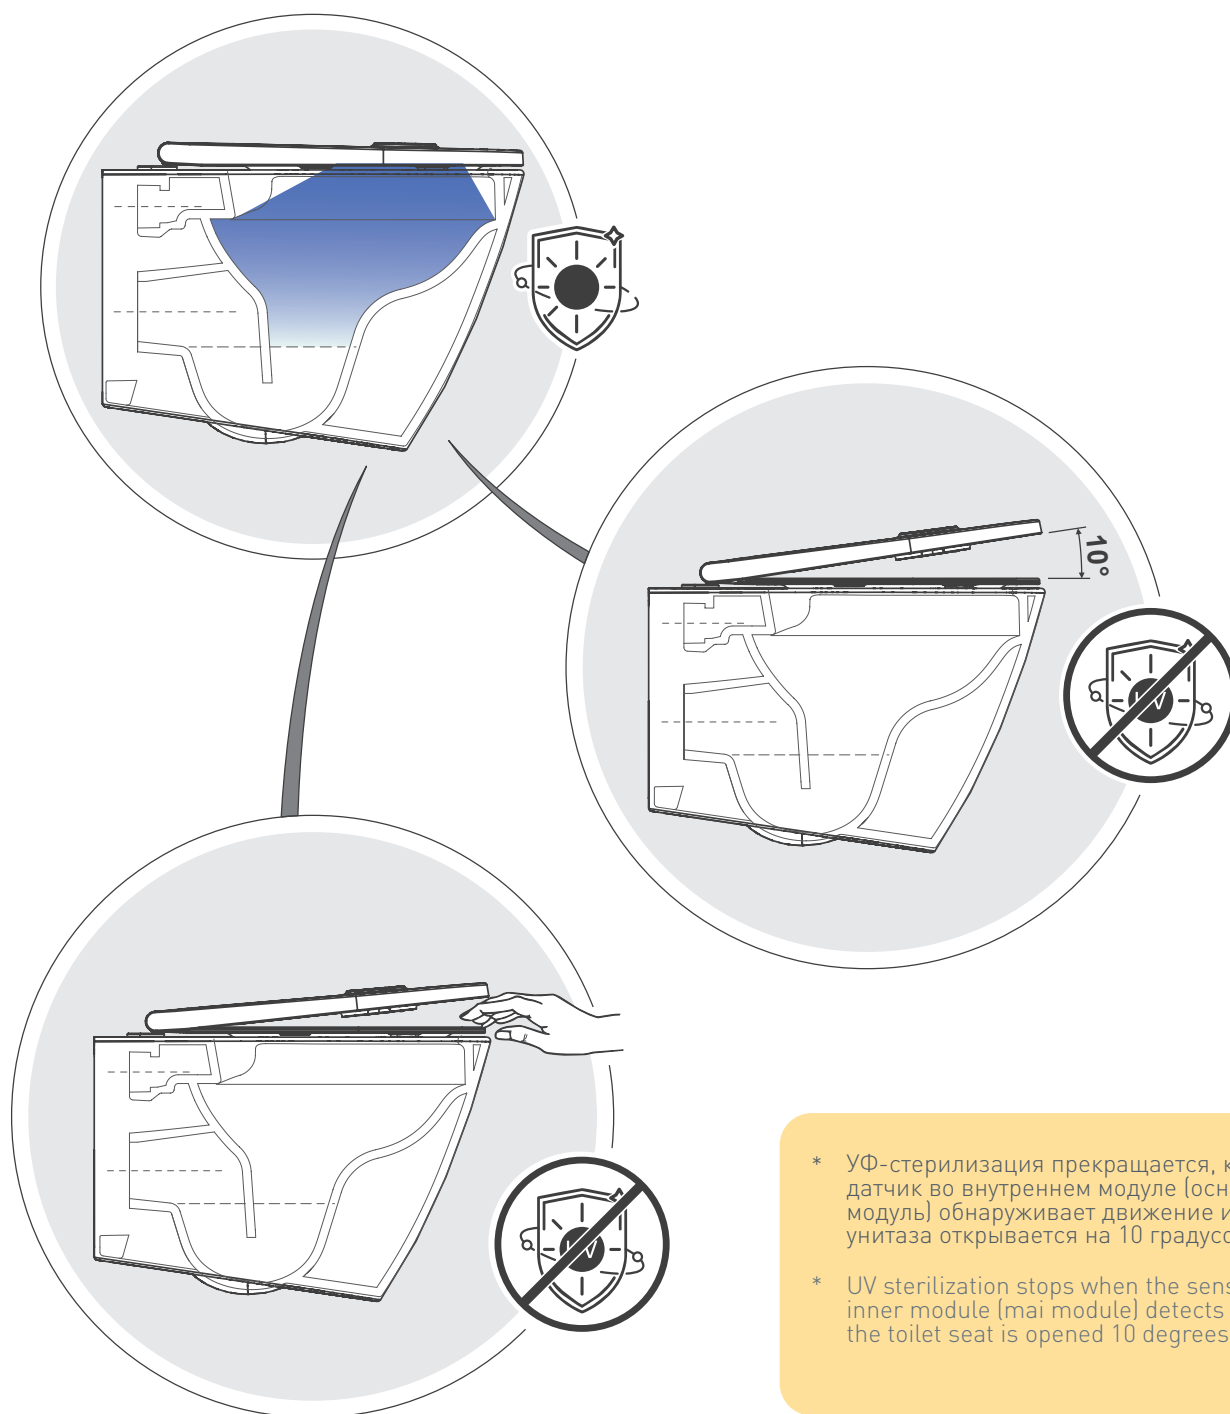

- * УФ-стерилизация прекращается, когда датчик во внутреннем модуле (основной модуль) обнаруживает движение и сиденье унитаза открывается на 10 градусов.
- * UV sterilization stops when the sensor in the inner module (main module) detects motion and the toilet seat is opened 10 degrees.



THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения


Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device



THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения


Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

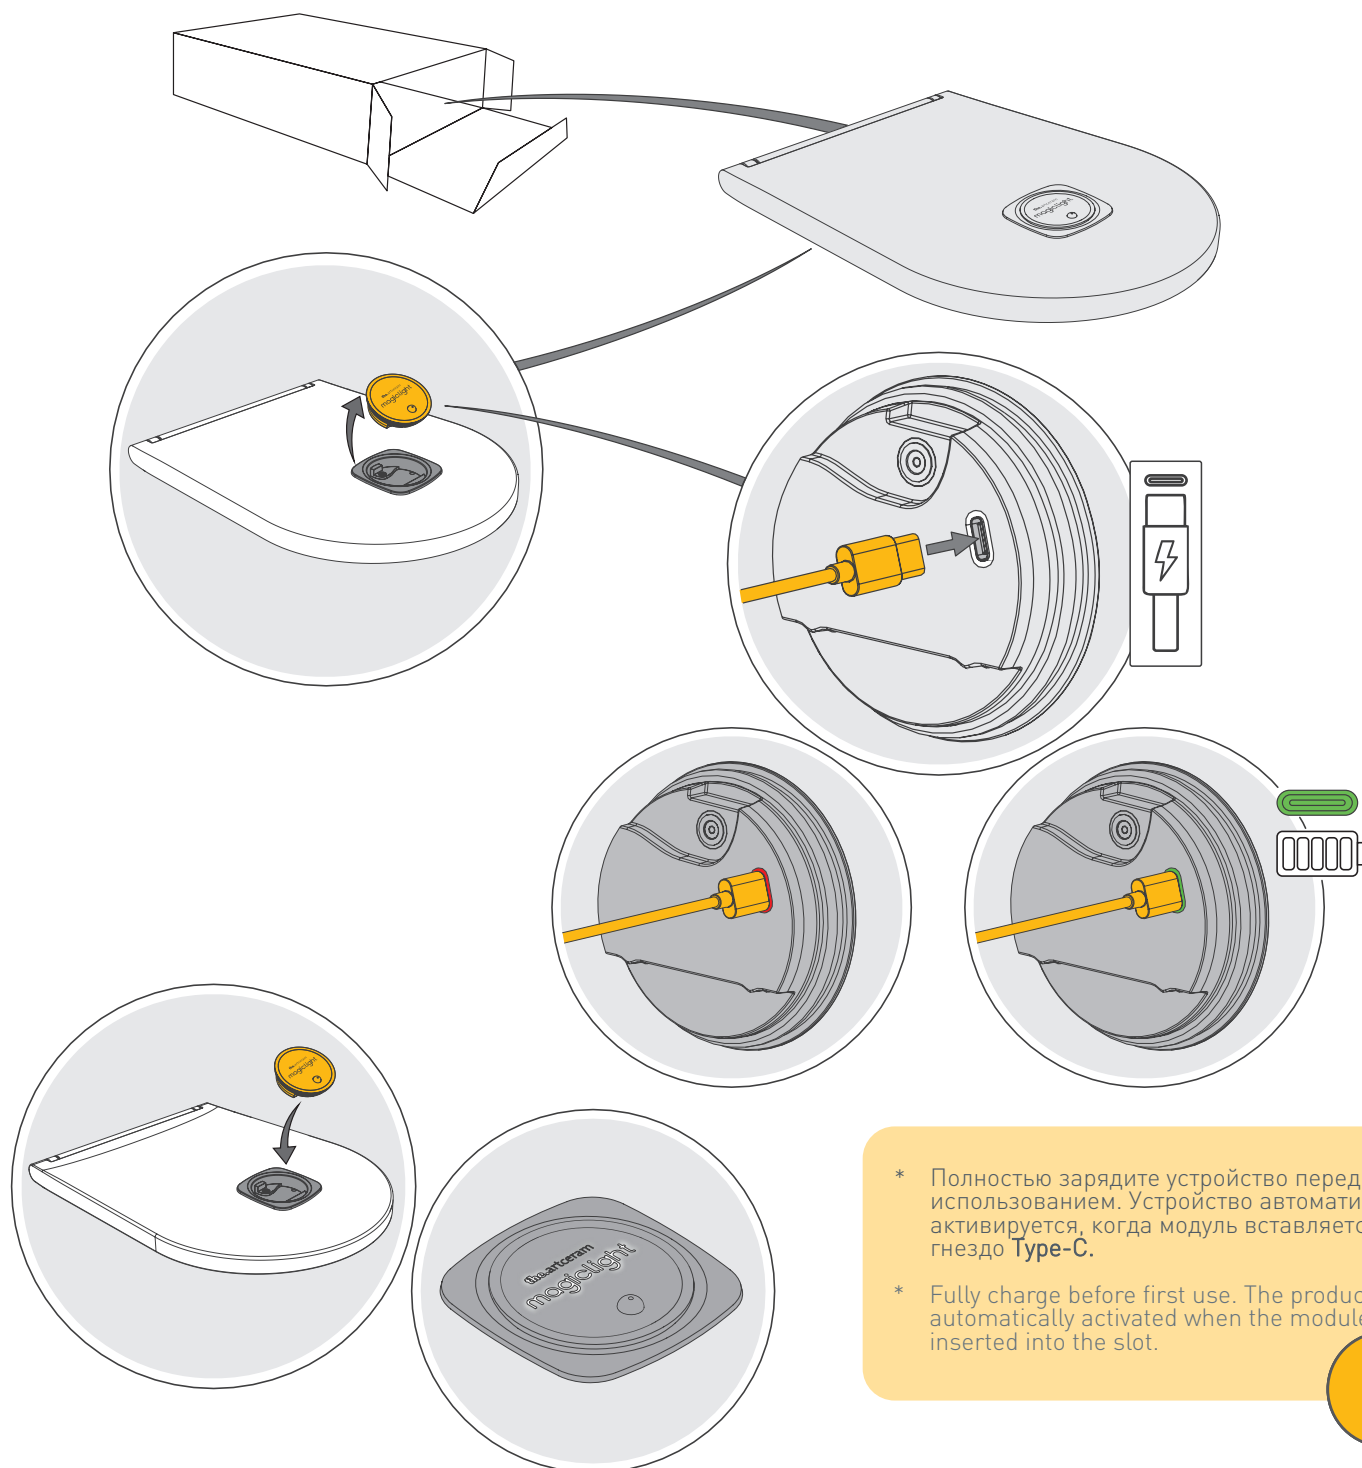

THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения


Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

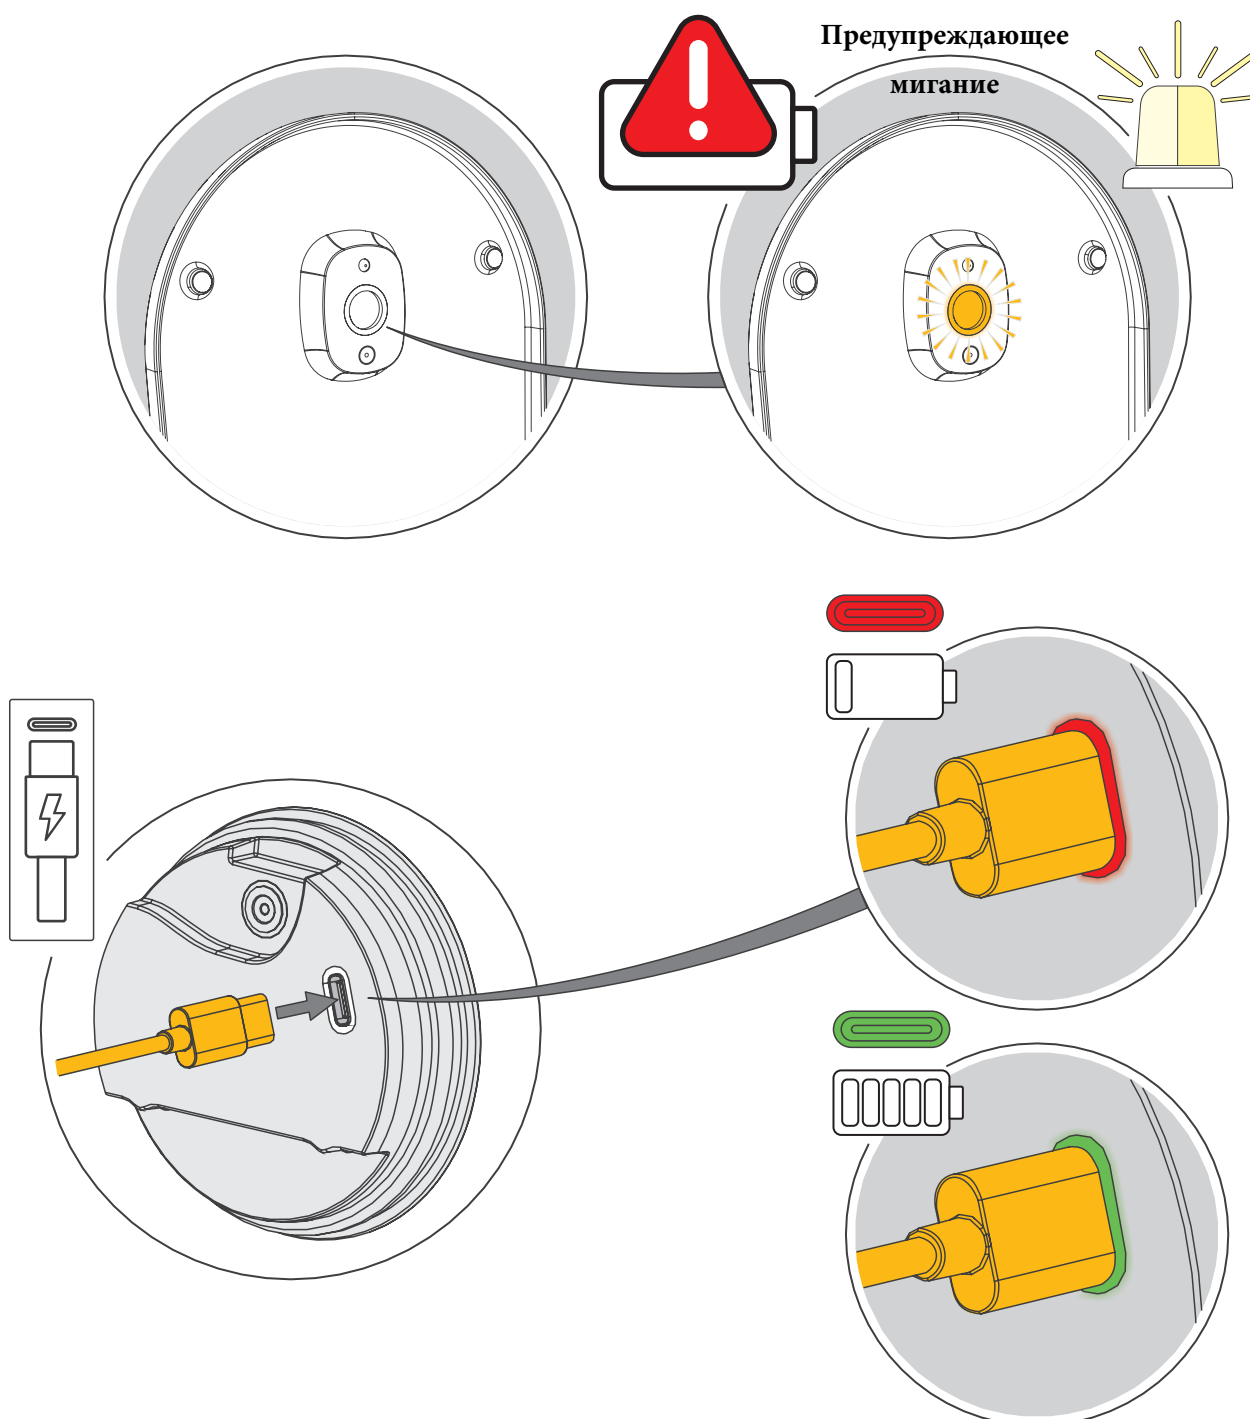

THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения


Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

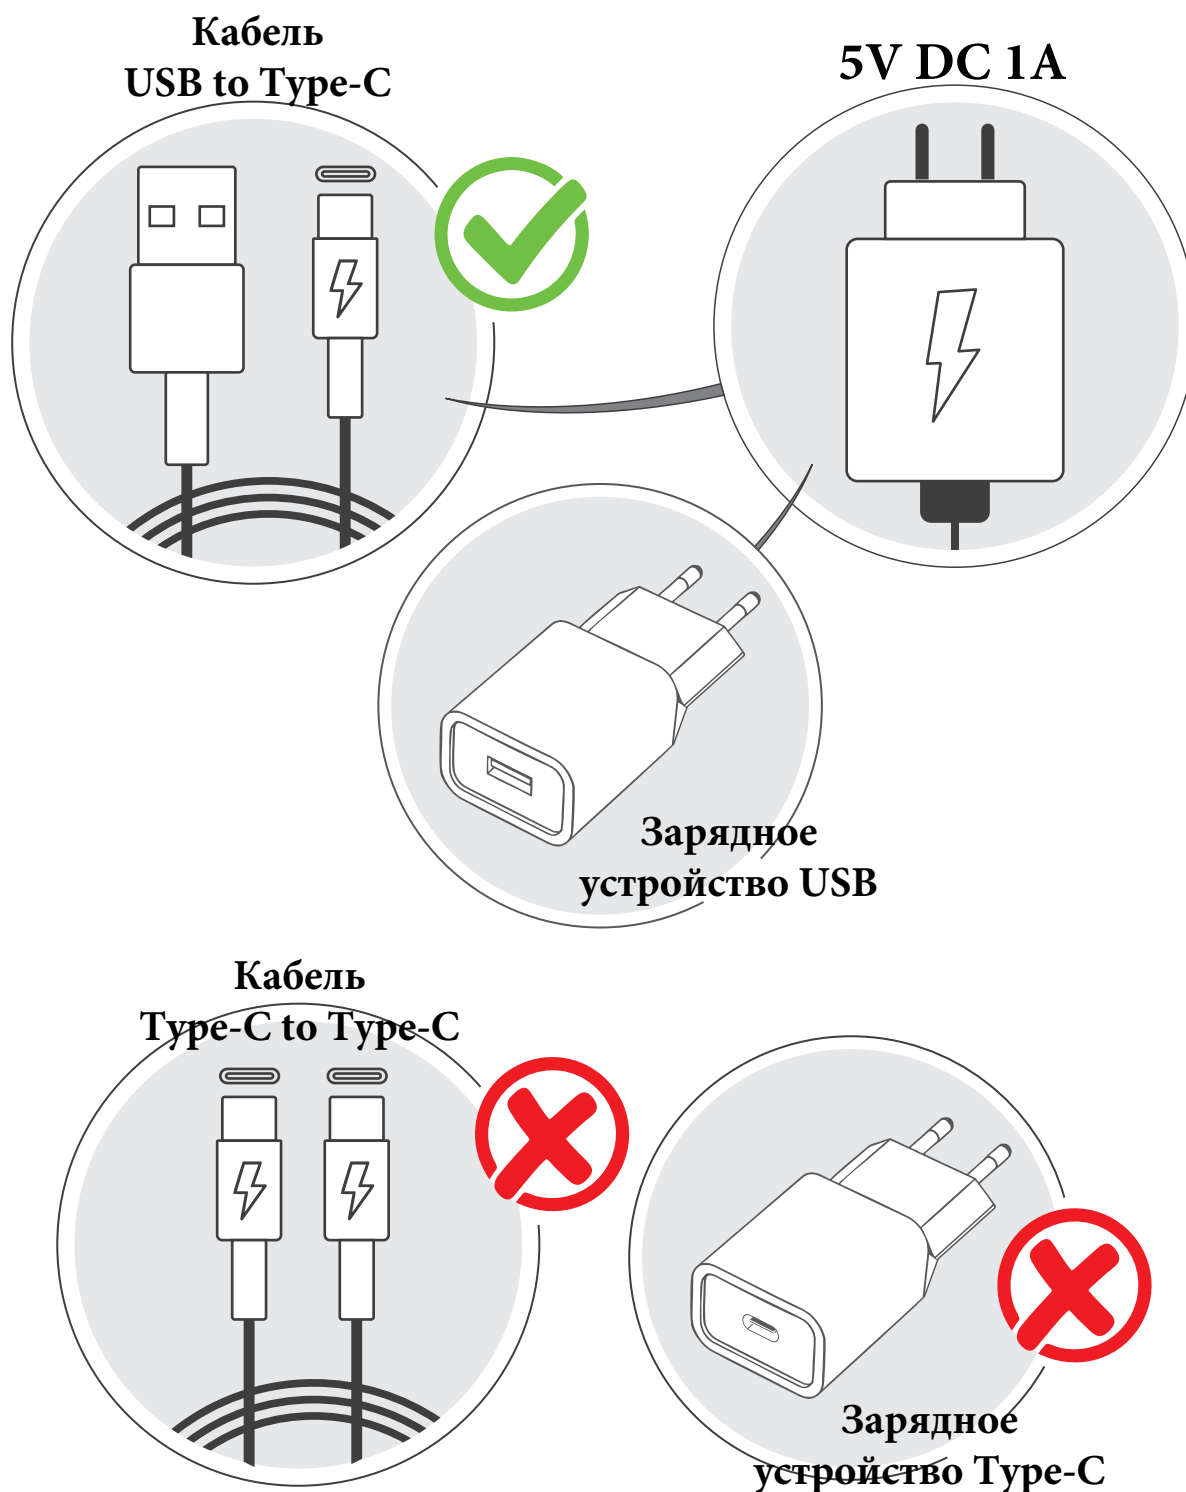

THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения


Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

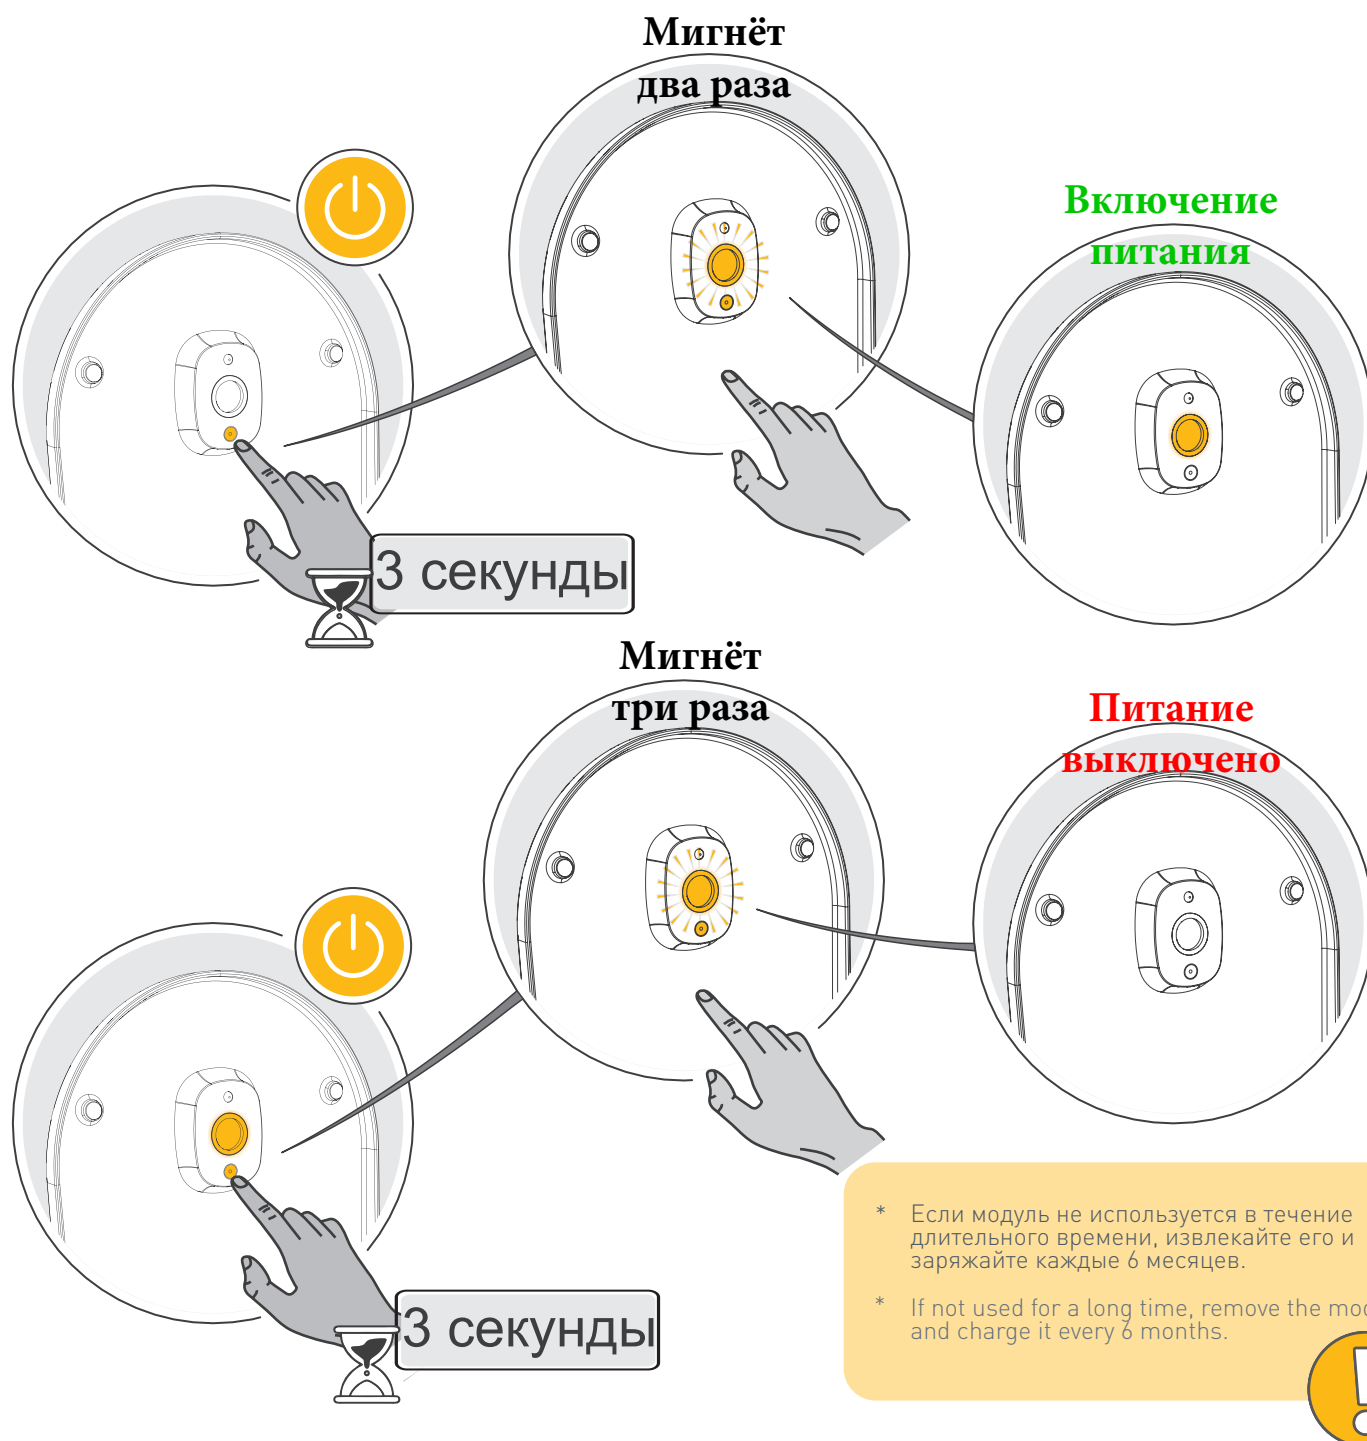

THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения


Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

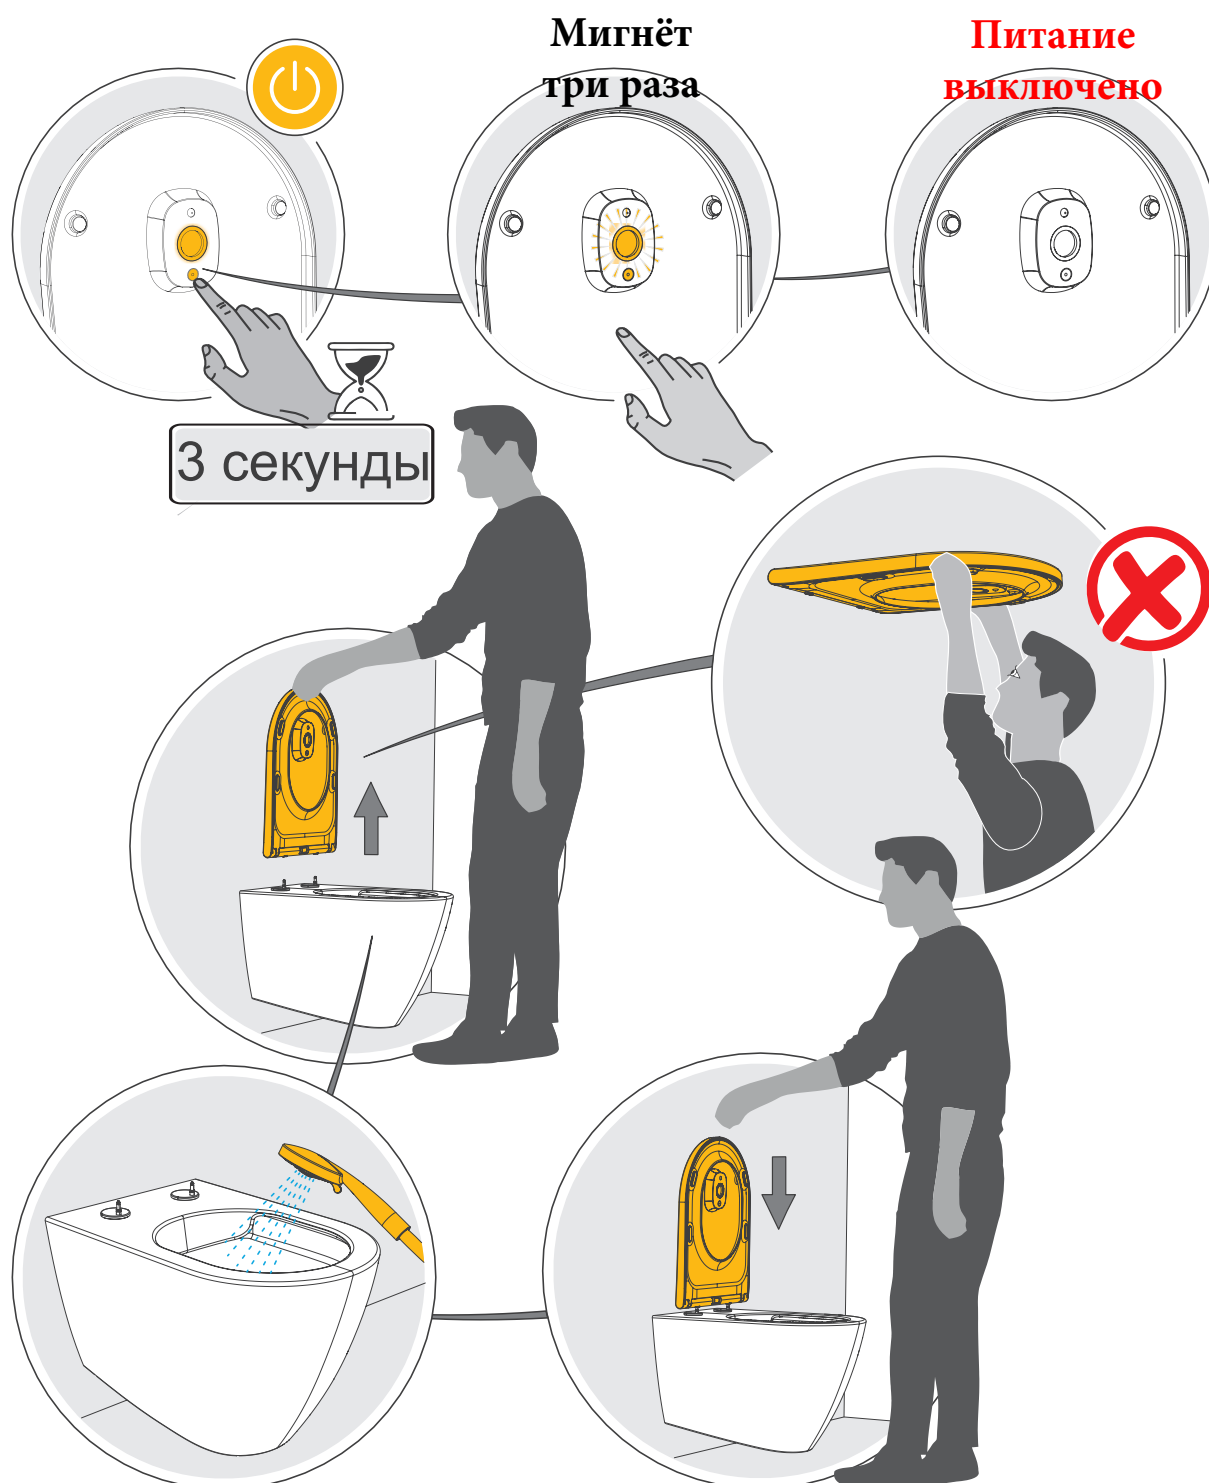

THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения




Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

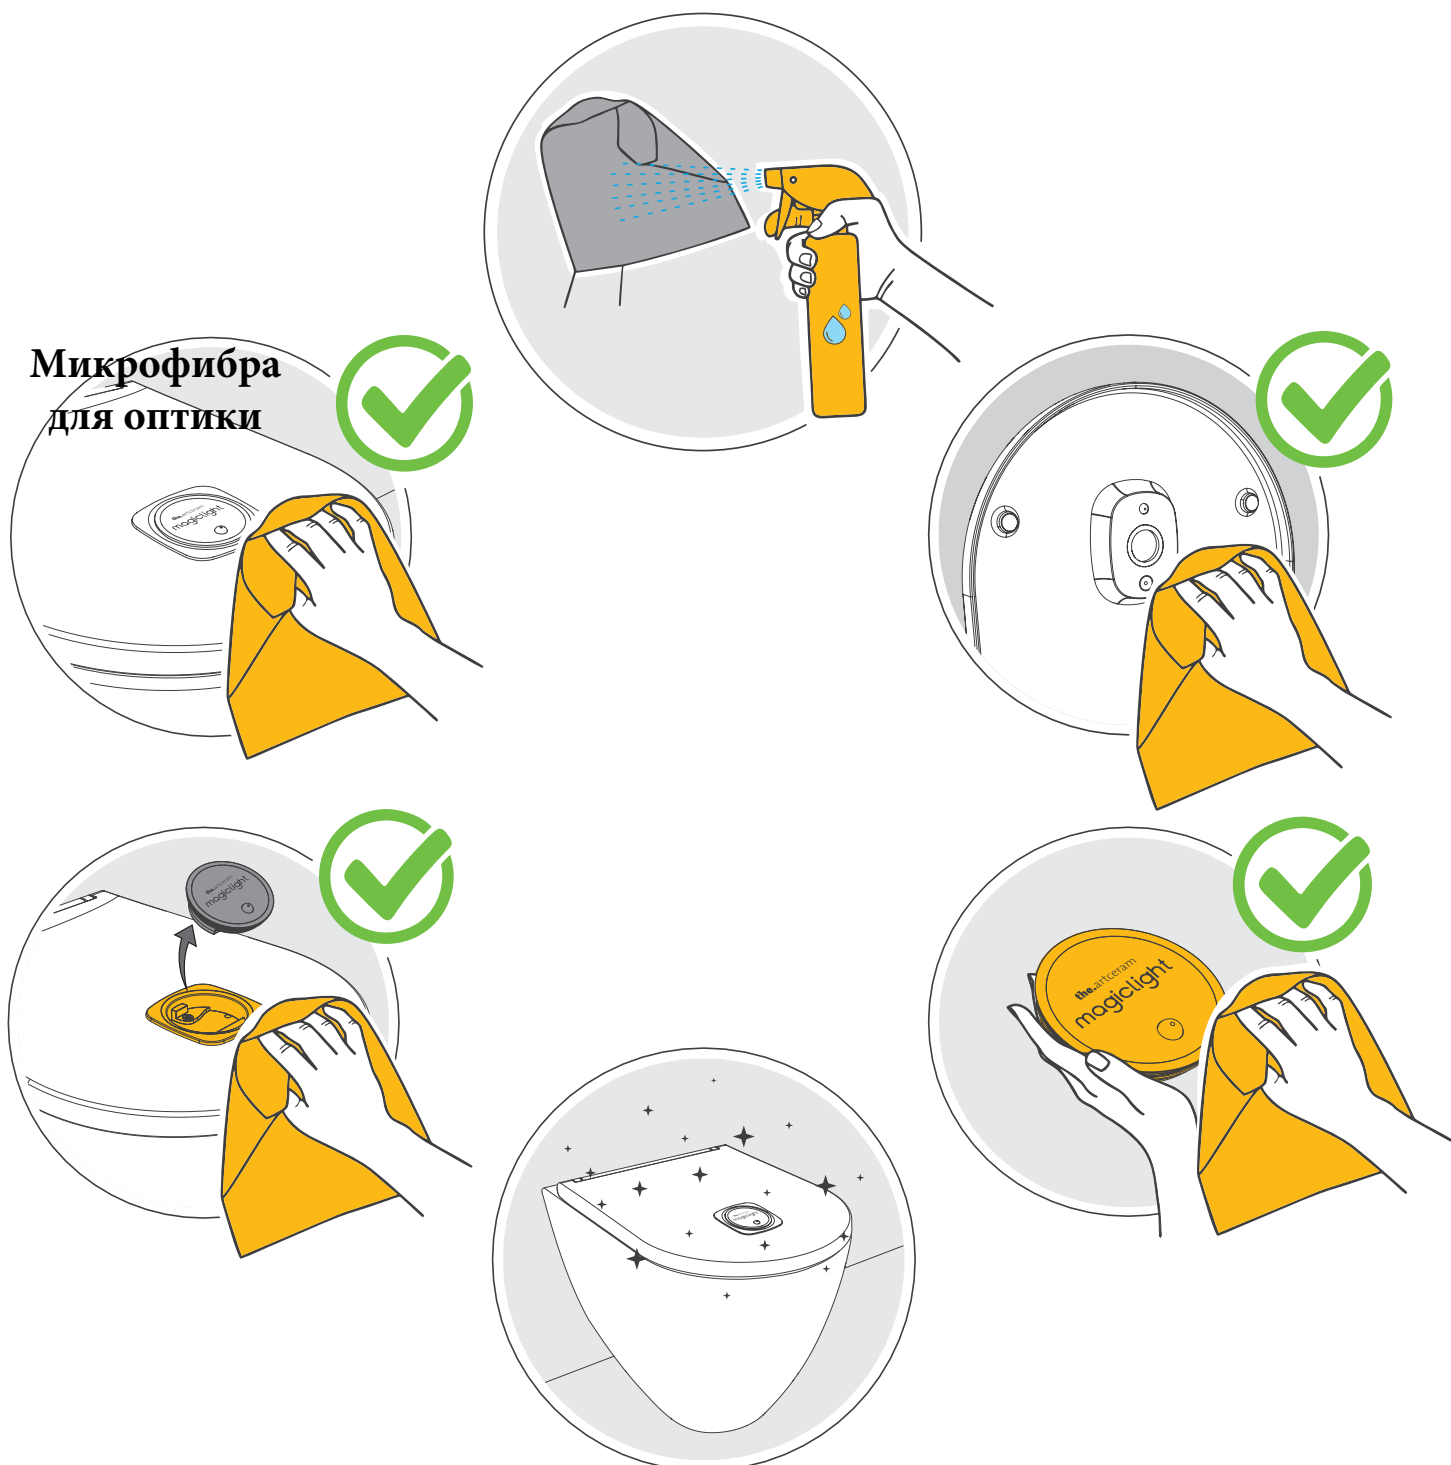

THE.MAGICLIGHT

Инструкция по монтажу | Устройство для ультрафиолетового антисептического облучения

Assembly Instructions | Ultraviolet Antiseptic Irradiation Device

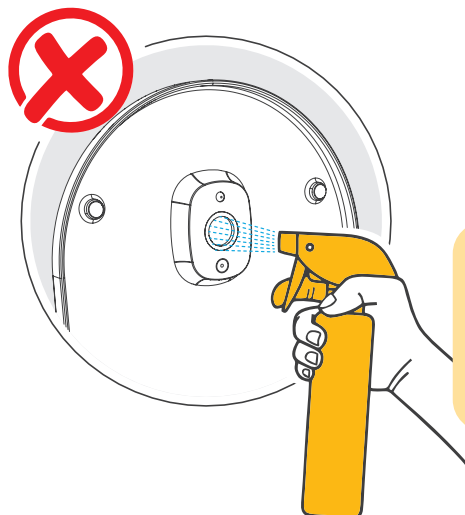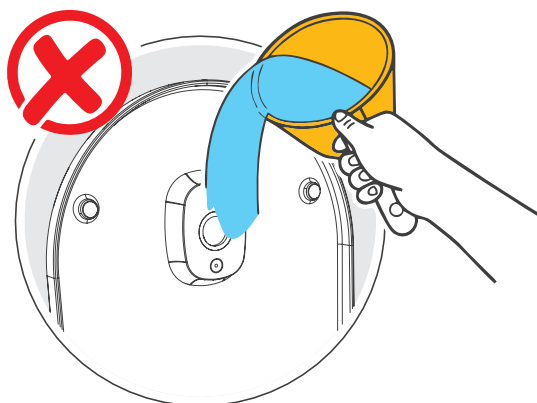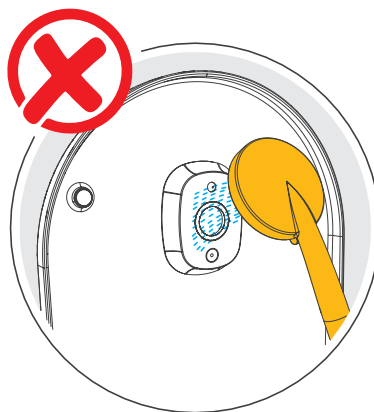

- * Избегайте контакта с водой
- * Avoid contact with water.

